


ЛПА-800 Схемы подключения датчиков к каналу №1

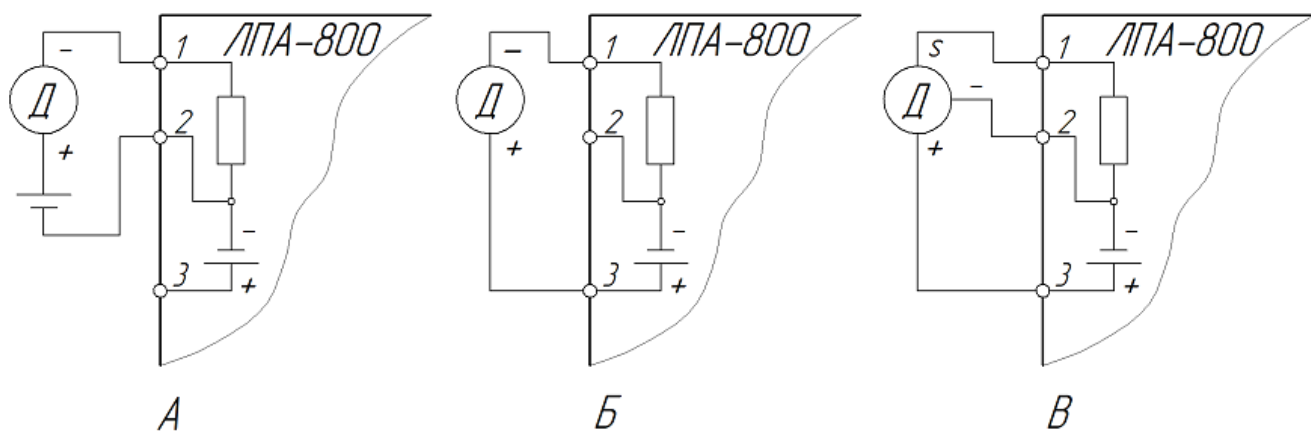

*А – активный датчик с внешним или встроенным источником питания,
Б – пассивный датчик по двухпроводной схеме,
В – пассивный датчик по трехпроводной схеме включения.*